



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2245182

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

13.08.2018 № 014-1967/18

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О фальсифицированном  
медицинском изделии

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о выявлении в обращении на территории Российской Федерации фальсифицированного медицинского изделия:

«Contex® с анестетиком Long Love. 3 презерватива CONTEX LONG LOVE (Лонг Лав) прямой формы с накопителем», сопровождаемого сведениями о производителе «ЛРС Продактс Лтд», Великобритания, и регистрационном удостоверении № ФСЗ 2010/07025 от 08.08.2014.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести проверку наличия в обращении указанного Медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации фальсифицированного медицинского изделия и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий, утвержденным приказом Минздрава России от 05.04.2013 № 196н.

За нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», а также установлена уголовная ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий согласно статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.



Приложение: таблица сравнения идентификационных признаков образца медицинского изделия, представленного производителем, и образца выявленного медицинского изделия на 5 л.


Руководитель



М.А. Мурашко



**Таблица сравнения идентификационных признаков образца медицинского изделия, представленного производителем, и образца выявленного медицинского изделия**

Признак фальсификации	Оригинальные образцы	Фальсифицированные образцы
Адрес места производства (имеются отличия в количестве заводов, в пояснениях относительно кодировки заводов в обозначении LOT, в слове «Мануфэктуринг»)	- «Суретекс Лимитед», 71 Сап Рoad, Сифайя, Банграк, Бангкок 10500, Таиланд (S) - ЭсЭсЭл Мануфэктуринг (Таиланд) Лтд., Веллгроу Индастриал Эстейт, 100 Моо 5, Бангна-Трад Роуд 36 км, Бангсамак, Бангпаконг, Чачоенгсао, 24180, Таиланд (B).	ЭсЭсЭл Мануфактуринг Тайланд) Лтд., Веллароу Индастриал Эстейт, 100 Моо 5, Бангна-Трад Роуд 36 км, Бангсамак, Бангпаконг, Чачоенгсао, 24180, Тайланд.
Уполномоченная организация / Импортер	ООО «Медком-МП»	ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»
Внешний вид изделия	Образец с условным обозначением А имеет «мутноватый» оттенок	Образец с условным обозначением В полностью прозрачный
Упаковка (имеются отличия в части внешнего индивидуальной фольгированной упаковки; картонной упаковки в части цвета, шрифтов и символов)	См.Приложение 3 	См.Приложение 3 

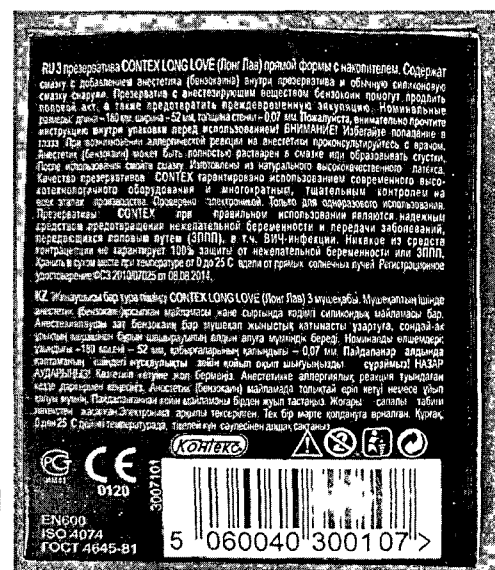

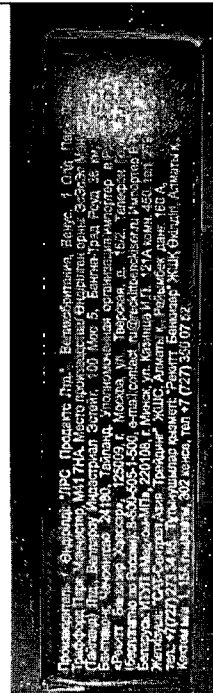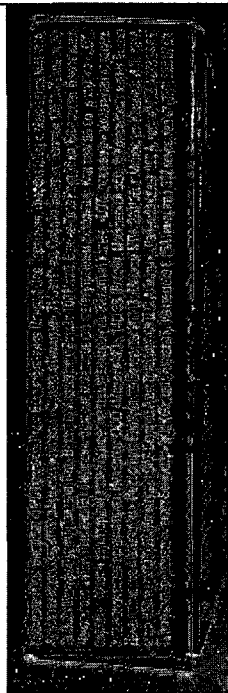

## Инструкция (внешний вид и содержание)

### Contex берегите любовь...

Представляем Вам серию высококачественных презервативов CONTEX®. В широком спектре презервативов Contex® вы найдете для себя тот вид, который подходит вам наилучшим образом. Соответствуют европейскому и международному стандартам. Надеемся, что вы отдадите предпочтение нашей продукции.

Более подробную информацию вы можете найти [www.contex-condom.com](http://www.contex-condom.com). Мы будем рады получить Ваши отклики и предложения на наш e-mail: [info@contex-condom.com](mailto:info@contex-condom.com), а также по телефону: 127360, Москва, м/л 25.

Изготовлены из натурального высококачественного латекса. Качество презервативов Contex® гарантировано использованием современного высокотехнологичного оборудования и многократным, тщательным контролем на всех этапах производства.

**КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕЗЕРВАТИВОМ**

Пользуйтесь новым презервативом каждый раз, когда занимаетесь сексом. При использовании презерватива не прикасайтесь к другим предметам. Надевайте презерватив на половой член до начала полового контакта.

Расположите свернутый презерватив на головке эрегированного полового члена. Сдвиньте рукой пальцами презерватив по направлению к основанию полового члена. Расправьте презерватив по направлению к основанию полового члена. Сразу после эрекции извлеките пенис, прижав к нему кончик презерватива, чтобы он не сократился. Аккуратно снимите презерватив, придерживая его у основания. Сверните использованный презерватив и выбросьте его. Никогда не бросайте презерватив в унитаз.

**ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА НАРУШЕНИЯ ЦЕЛЮСТНОСТИ ПРЕЗЕРВАТИВА**

Подвержено воздействию.

Хранить в сухом месте при температуре от 0 до 25°C вдали от прямых солнечных лучей.

Выбрасывайте презерватив после использования, если его упаковка (фолдс) помята, расклевана или обнаружены дефекты.

Не пользуйтесь в качестве барьерного средства растительными, животными и кулинарными жирами, а также лосьонами и мылом.

**ПРЕЗЕРВАТИВ КАКАЯ КОЛДАНУ КЕРЕК**

Эр жимым, катынас кезинде жаңа презервативті колдану керек. Презервативті қатты, откір, үшкір затпен ашуға болмайды. Презервативті жынның қатынасында кінәлі.

Жынып, қиналып тұрған презервативті жынның мүйісінің басына қойып жүргізсе жінге екі саусағымен ішіндегі ауаны шығарыңыз.

Презервативті дұрыс жолмен жыныс мүшесінің ұзындығымен дұрыс алып алыңыз.

Включившись кезін, презервативті қиспы, жойлап шешіңіз. Өйткені сырғанап, сырғип кетуі мүмкін.

Қолдануға презервативті дұрыс алып, алақаның, лақтырып тастаймыз. Дүреткінаға тастауға болмайды.

**ПРЕЗЕРВАТИВТІ БҮТІН ҚАЛЫП САҚТАУ**

Электрондымен тексеру.

Қыраы-сыңып жолға сақтау және істан қысырлесінен алыстау керек.

Егер упаковка мыңылған немесе бір дефекті болса қолдануға болмайды.

Мая жануардыңмайын, лосын мен қазелин, бесқад смайілер қолдануға болмайды.



cherish your love...

1. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

2. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

3. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

4. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

5. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

6. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

7. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

8. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

9. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

10. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

11. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

12. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

13. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

14. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

15. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

16. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

17. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

18. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

19. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

20. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

21. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

22. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

23. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

24. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

25. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

26. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

27. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

28. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

29. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

30. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

31. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

32. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

33. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

34. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

35. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

36. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

37. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

38. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

39. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

40. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

41. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

42. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

43. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

44. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

45. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

46. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

47. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

48. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

49. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

50. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

51. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

52. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

53. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

54. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

55. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

56. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

57. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

58. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

59. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

60. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

61. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

62. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

63. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

64. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

65. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

66. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

67. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

68. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

69. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

70. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

71. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

72. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

73. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

74. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

75. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

76. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

77. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

78. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

79. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

80. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

81. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

82. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

83. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

84. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

85. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

86. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

87. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

88. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

89. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

90. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

91. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

92. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

93. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

94. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

95. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

96. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

97. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

98. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

99. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.

100. JAC Презервативті 100% қамтамасыз етеді және оны 100% қамтамасыз етеді.







		что не соответствует действительности;
Сведения о регистрации	№ ФСЗ 2010/07025 от 14.03.2013	№ ФСЗ 2010/07025 от 08.08.2014* * Дата выдачи регистрационного удостоверения не соответствует дате производства 2018 года (при сроке годности 5 лет), на 2018 год актуальная дата регистрационного удостоверения - 26.12.2017 и номер РЗН 2017/5083.
Размеры (длина)	<u>Длина без накопителя</u> A1 – 190,0 мм; A2 – 192,0 мм; A3 – 188,0 мм. <u>Ширина</u> A1 – 52,0 мм; A2 – 52,0 мм; A3 – 52,0 мм. <u>Толщина стенки</u> A1 – 0,06 мм; A2 – 0,06 мм; A3 – 0,06 мм. <u>Ширина кольца</u> A1 – 1,63 мм; A2 – 1,55 мм; A3 – 1,59 мм.	<u>Длина без накопителя</u> B1 – 169,0 мм; B2 – 169,0 мм; B3 – 172,0 мм. <u>Ширина</u> B1 – 50,0 мм; B2 – 51,0 мм; B3 – 51,0 мм. <u>Толщина стенки</u> B1 – 0,05 мм; B2 – 0,05 мм; B3 – 0,05 мм. <u>Толщина кольца</u> B1 – 1,56 мм; B2 – 1,52 мм; B3 – 1,56 мм.